



1 Inhalt

1	Inhalt	1
2	System	3
2.1	Systemübersicht	3
3	Erste Schritte	4
4	Offline Konfiguration	5
5	Lizenzen	6
6	testo Saveris 2 App.....	7
7	Funk-Datenlogger	9
7.1	Technische Daten	9
7.1.1	Messspezifische Daten.....	9
7.1.2	Allgemeine Daten.....	10
7.1.3	Funkspezifische Daten	13
7.1.4	Technische Vorgaben für ein gesichertes WLAN	13
7.1.5	Zulassungen	15
7.1.5.1	Europäische Union, EFTA-Staaten	16
7.1.5.2	USA / Kanada	21
7.1.5.3	Japan.....	21
7.1.5.4	Australien.....	22
7.1.5.5	China	22
7.1.5.6	Korea	22
7.1.5.7	Russland.....	22
7.1.5.8	Chile.....	23
7.1.5.9	Singapur	23
7.1.5.10	Ukraine	23
7.1.5.11	Vereinigte Arabische Emirate.....	23
7.1.6	Zulassungen (2016)	23
7.2	Sicherheit und Umwelt.....	28
7.2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	28
7.2.2	Sicherheitshinweise für Patienten mit einem Herzschrittmacher oder implantiertem Herzschrittmacher....	28
7.2.3	Batterien	28
7.2.4	Umwelt schützen.....	29
7.3	Wandhalterung.....	29

7.4	Anzeige- und Bedienelemente.....	32
7.4.1	Übersicht	32
7.4.2	Displaysymbole.....	32
7.4.3	LED-Anzeige – Konfiguration	33
7.4.4	LED-Anzeige – Betrieb.....	34
8	Benutzeroberfläche	35
9	Dashboard	36
9.1	Messstellen.....	36
9.2	Aktive Alarme.....	36
10	Analyse & Berichte	36
10.1	Automatische Berichte	36
11	Alarme	38
11.1	Alarmliste.....	38
11.2	Alarmeinstellungen	38
11.3	Systemwarnungen.....	40
12	Konfiguration	41
12.1	Benutzer	41
12.2	Benutzerrollen.....	42
12.3	Account ID.....	43
12.4	Messstellengruppen	43
12.5	Bereiche	44
12.6	Funk-Datenlogger.....	44
12.7	Firmware Updates	45
13	Benutzerverwaltung	46
13.1	Benutzereinstellungen	46
13.2	Kontoinformationen	46
13.3	Passwort ändern.....	46
13.4	Abmelden	46
14	Befehlsleiste	47
14.1	Quick Start Guide öffnen	47
14.2	Online Hilfe öffnen	47
14.3	Systemnachrichten öffnen.....	47
15	System- und Statusinformationen	48
15.1	Systemstatus anzeigen.....	48
16	Häufig gestellte Fragen	48
17	Änderungshistorie.....	53

2 System

2.1 Systemübersicht

Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 ist die moderne Lösung zur Überwachung von Temperatur- und Feuchtwerten in Lager- und Arbeitsräumen.

Das System besteht aus Funk-Datenloggern und einem Cloud-Datenspeicher. Die Funk-Datenlogger testo Saveris 2 zeichnen zuverlässig Temperatur und Feuchte in einstellbaren Intervallen auf und funken die Messwerte direkt über WLAN in die Testo-Cloud. Die in der Cloud gespeicherten Messwerte können jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC ausgewertet werden. Grenzwert-Überschreitungen werden sofort per E-Mail oder optional per SMS gemeldet.

Auf die gleiche Weise können Funk-Datenlogger über die Testo-Cloud programmiert sowie Auswertungen und Analysen angefordert werden.

Messwernerfassung mit Funkdatenlogger



WLAN-Router (kundenseitig)



Speicherung der Messwerte in der Testo-Cloud



Messwerte auf beliebigem Endgerät abrufen: PC, Smartphone, Tablet




3 Erste Schritte

1. Entnehmen Sie den Datenlogger aus der Verpackung.
2. Lösen Sie den Datenlogger aus der Wandhalterung. (Siehe Kapitel 7.3)
3. Lockern Sie den Batteriedeckel durch leichtes Lösen der Schrauben auf der Gehäuserückseite.
4. Ziehen Sie den Trennstreifen aus dem Batteriefach.
Der Datenlogger ist jetzt aktiviert.
5. Ziehen Sie die Schrauben auf der Gehäuserückseite wieder an.

Als Hilfestellung bei den ersten Schritten der Inbetriebnahme von testo Saveris 2 steht Ihnen der Quick Start Guide zur Verfügung.

Er unterstützt Sie beim Anmelden von Funk-Datenloggern.

- Klicken Sie in der Befehlsleiste auf das Symbol , um den **Quick Start Guide** zu öffnen.

4 Offline Konfiguration

Alternativ zur Erstellung der Konfigurationsdatei im Quick Start Guide mit anschließendem Download der XML-Konfigurationsdatei kann der Funk-Datenlogger auch über ein PDF-Formular konfiguriert werden.



Hinweis

Sie benötigen das Programm Adobe Reader (Version 10 oder höher), um das PDF-Formular korrekt auszuführen. Falls Sie den adobe Reader nicht installiert haben, können Sie ihn unter folgender Adresse kostenlos herunterladen: <http://get.adobe.com/reader/>.

1. Verbinden Sie den Funk-Datenlogger mit dem PC.
2. Öffnen Sie die Datei **WifiConf.pdf**, die Sie sich auf dem externen Laufwerk **SAVERIS 2** befindet.
3. Kopieren Sie Ihre Account ID und fügen Sie sie in das entsprechende Feld im PDF-Formular ein. Sie finden die Account ID in der testo Saveris 2 Software unter **Konfiguration -> Account ID**.
4. Tragen Sie Ihren **Netzwerknamen (SSID)** und ggf. Ihr **WLAN-Passwort** in die entsprechenden Felder des PDF-Formulars ein.
5. Klicken sie auf die Schaltfläche **Save configuration**.
Ein Dialogfeld zum Exportieren der Formulare Daten wird geöffnet.
6. Wählen Sie als Speicherort das externe Laufwerk **SAVERIS 2** aus und speichern Sie die Formulare Daten (Konfigurationsdatei **WiFiConf_Daten.xml**) darauf ab.
7. Trennen Sie die USB Verbindung zum PC um die Konfiguration des Loggers abzuschließen.



Hinweis

Sie können die Konfigurationsdatei auch lokal auf Ihrem Computer speichern und weitere Funk-Datenlogger durch einfaches Kopieren der XML-Konfigurationsdatei auf denen externes Laufwerk (**Saveris 2**) noch schneller konfigurieren.

5 Lizenzen

Mit dem Erwerb Ihres Saveris 2 Systems erhalten Sie eine kostenlose Basislizenz.

Manche Mess-Funktionen werden in Ihrem Saveris 2 System zwar angezeigt, sind aber inaktiv, durch eine Erweiterung Ihrer Lizenz können Sie diese Funktionen aktivieren und verwenden. In der Kopfzeile wird Ihnen angezeigt welche Lizenz sie aktuell haben.

Lizenz erwerben

Durch anklicken der Lizenz-Anzeige in der Kopfzeile, öffnet sich der Lizenz-Shop, hier können Sie sich Ihre Lizenzerweiterung auswählen und erwerben.

Oder

Sie klicken auf das Symbol neben der inaktiven Mess-Funktion



. Damit öffnet sich ebenfalls der Lizenz-Shop und sie können Ihre Lizenz erweitern.

6 testo Saveris 2 App

Die kostenlose testo Saveris 2 App bietet Ihnen praktische Funktionen zur Inbetriebnahme, der Netzwerkanalyse und dem Empfang von Saveris 2 Push- Nachrichten.

Leistungsbeschreibung der testo Saveris 2 App

Inbetriebnahme

Mit Hilfe des Konfigurationsassistenten erfolgt eine benutzerfreundliche Erkennung und Auswahl des WLAN Netzwerkes, welches eine einfache und schnelle Einbindung der Logger ermöglicht .

Push Empfänger:

Adressaten, die beim Auftreten eines Alarms informiert werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor dem Empfänger um Push-Nachrichten zu versenden.

Bitte beachten Sie, dass die kostenlose testo Saveris 2 App auf Ihrem Android oder IOS-Gerät installiert sein muss, um Push-Nachrichten zu empfangen.

Um die einfache Logger Inbetriebnahme mit Hilfe der Saveris 2 App zu nutzen, müssen die Logger¹ durch kurzes Drücken (2 sec) der Bedientaste in einen 5 min Hotspot-Modus versetzt werden. Logger² mit WPA2 Enterprise Funktionalität werden durch zweimaliges, kurzes Drücken in den Hotspot-Modus versetzt. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn sich der Logger nach Auslieferung im Werkszustand befindet. Ein bereits konfigurierter Logger kann entweder durch Abmeldung im Web Frontend oder durch längeres Drücken der Bedientaste (>30 sec) wieder in den Werkszustand versetzt werden. Wird die

¹ Für Artikelnummer: 0572 2001, 0572 2002, 0572 2003, 0572 2004, 0572 2005

² Für Artikelnummer: 0572 2031, 0572 2032, 0572 2033, 0572 2034, 0572 2035

Bedientaste bei der Erstinbetriebnahme irrtümlich gedrückt, kann der Hotspot-Modus durch kurze Entnahme der Batterien abgebrochen werden.



Achtung

Bei Konfiguration der Logger mit Hilfe der testo Saveris 2 App wird das Smartphone in einen Access Point verwandelt und die voreingestellten Access-Point-Einstellungen werden geändert. Nach Abschluss der Konfiguration müssen diese ggf. wieder manuell angepasst werden.

Netzwerkanalyse

Mit Hilfe der Netzwerkanalyse können Sie vorab ihr WLAN Netzwerk analysieren um die Voraussetzungen für den korrekten Betrieb der testo Saveris 2 Logger zu prüfen.

Zusätzlich können Sie optional Statusprotokolle erstellen und versenden.



Bitte beachten Sie, dass die Logger-Inbetriebnahme sowie die Netzwerkanalyse infolge IOS Systembeschränkungen nur auf Android Geräten durchgeführt werden kann

Alarme

Mit der testo App können Sie alle Saveris 2 Push-Alarme empfangen und erhalten eine Übersicht.



Um eine Verbindung herstellen zu können benötigen Sie ein Tablet oder Smartphone auf dem Sie die Testo-App bereits installiert haben.

Die App erhalten Sie für iOS Geräte im AppStore oder für Android-Geräte im Play Store.

Kompatibilität

Erfordert iOS 8.3 oder neuer / Android 4.3 oder neuer



Push-Alarme werden nicht nachgesendet, wenn das Smart Phone ausgeschaltet ist oder der Provider-Dienst nicht zur Verfügung steht.

7 Funk-Datenlogger

7.1 Technische Daten

7.1.1 Messspezifische Daten

Funk-Daten-logger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2001	0572 2002	0572 2003	0572 2004	0572 2005
Sensortyp	1x NTC intern	2x NTC oder Türkontakt extern	2x Thermoelement Typ K / J / T extern	1x NTC / Feuchte intern	1x NTC / Feuchte extern
Messbereich	-30 ... +50 °C	-50 ... +150 °C	K: -195...+1350°C J: -100...+750°C T: -200...+400°C	-30 ... +50° C 0 ... 100 %rF F ³	Fühler-spezifisch
Genauigkeit ±1 Digit	±0,5 °C	±0,5 °C	± (0,5 C + 0,5 % vom Messwert)	±0,5 °C ±2 %rF (bei 25 °C, 2...98 rF)	Fühler-spezifisch
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C	0,1 C (-200...+999,9°C) 1 °C (restlicher Bereich)	0,1 °C 0,1 % rF	0,1 °C 0,1 % rF

Funk-Daten-logger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2031	0572 2032	0572 2033	0572 2034	0572 2035
Sensortyp	1x NTC intern	2x NTC oder Türkontakt extern	2x Thermoelement Typ K / J / T extern	1x NTC / Feuchte intern	1x NTC / Feuchte extern

³ Nicht für betauende Atmosphäre. Für kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (> 80 % rF bei ≤ 30 °C für > 12 h, > 60 % rF bei > 30 °C für > 12 h) kontaktieren Sie uns bitte (www.testo-international.com).

Funk-Daten-logger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2031	0572 2032	0572 2033	0572 2034	0572 2035
Messbereich	-30 ... +50 °C	-50 ... +150 °C	K: -195 ... +1350 °C J: -100 ... +750 °C T: -200 ... +400 °C	-30 ... +50 °C 0...100 %rF ¹	Fühlerspezifisch
Genauigkeit ±1 Digit	±0,5 °C	±0,3 °C	± (0,5 °C + 0,5 % vom Messwert)	±0,5 °C ±2 %rF (bei 25 °C, 2...98 rF)	Fühlerspezifisch
Auflösung	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C 0,1 % rF	Fühlerspezifisch

Saveris 2 Funkdatenlogger werden standardmäßig mit einem Werks-Kalibrierzertifikat ausgeliefert. In vielen Applikationen empfiehlt sich eine Re-Kalibrierung der Logger im Intervall von 12 Monaten. Diese können durch Testo Industrial Services (TIS) oder andere zertifizierte Dienstleister mit Hilfe einer leicht verwendbaren Service Software durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie Testo für weiterführende Informationen.

7.1.2 Allgemeine Daten

Funk-Datenlogger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2001	0572 2002	0572 2003	0572 2004	0572 2005
Betriebs-temperatur	-30 ... +50 °C				
Lagertemperatur (ohne Batterien)	-40 ... +60 °C				
Schutzklasse	IP 65	IP 65	IP 54	IP 30	IP 54
Messtakt	1 min ⁴ ... 24 h (15 Minuten voreingestellt)				
Kommunikations-takt	1 min ... 24 h (15 Minuten voreingestellt)				
Speicher	10 000 Messwerte / Kanal				

⁴ abhängig von gekaufter Lizenz

Funk-Datenlogger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2001	0572 2002	0572 2003	0572 2004	0572 2005
Batterie-standzeit	12 Monate ⁵ bei +25 °C, 15 min Messtakt, 30 min Tages-Kommunikationstakt (8 h / Tag) und 120 min Nacht-Kommunikationstakt ⁶ (16 h / Tag) bei -30 °C und 15 min Messtakt, 30 min Tages-Kommunikationstakt (8 h / Tag) und 120 min Nacht-Kommunikationstakt (16 h / Tag) mit Energizer-Batterien 0515 0572				
Spannungs-versorgung	4 x AA AIMn Mignonzellen Netzteil optional für Temperaturen unter -10 °C bitte Energizer-Batterien 0515 0572 verwenden				
Abmessungen	95 x 75 x 30,5 mm				
Gewich (inkl. Batterien)	240 g				
EN 12830 zertifiziert	ja	ja	nein	nein	nein
Türkontakt	nein	optional	nein	nein	nein
Wand-halterung	Im Lieferumfang enthalten				

Funk-Datenlogger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2031	0572 2032	0572 2033	0572 2034	0572 2035
Betriebs-temperatur	-30 ... +50 °C				
Lagertemperatur (ohne Batterien)	-40 ... +60 °C				
Lagertemperatur (mit beigelegten Batterien)	-10 ... +50 °C				
Lagertemperatur (mit Energizer, Li-Ionen Batterien)	-40 ... +60 °C				
Schutzklasse	IP 65	IP 65	IP 54	IP 30	IP 54
Messtakt	1 min ⁷ ... 24 h (15 Minuten voreingestellt)				

⁵ typischer Wert, abhängig von der WLAN-Infrastruktur

⁶ Energiesparbetrieb

⁷ abhängig von gekaufter Lizenz

Funk-Datenlogger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2031	0572 2032	0572 2033	0572 2034	0572 2035
Kommunikations-takt	1 min ... 24 h (15 Minuten voreingestellt)				
Speicher	10 000 Messwerte / Kanal				
Batterie-standzeit	12 Monate ⁸ bei +25 °C, 15 min Messtakt, 30 min Tages-Kommunikationstakt (8 h / Tag) und 120 min Nacht-Kommunikationstakt ⁹ (16 h / Tag) bei -30 °C und 15 min Messtakt, 30 min Tages-Kommunikationstakt (8 h / Tag) und 120 min Nacht-Kommunikationstakt (16 h / Tag) mit Energizer-Batterien 0515 0572				
Spannungs-versorgung	4 x AA AlMn Mignonzellen Netzteil optional für Temperaturen unter -10 °C bitte Energizer-Batterien 0515 0572 verwenden				
Abmessungen	95 x 75 x 30,5 mm	95 x 75 x 30,5 mm	95 x 75 x 30,5 mm	115 x 82 x 31,5 mm	95 x 75 x 30,5 mm
Gewich (inkl. Batterien)	240 g				
EN 12830 zertifiziert	ja	ja	nein	nein	nein
Türkontakt	nein	optional	nein	nein	nein
Wand-halterung	Im Lieferumfang enthalten				



Hinweis

Bitte beachten sie, dass für EN 12830 eine jährliche Überprüfung und Kalibrierung gemäß EN 13486 durchgeführt werden muss. Kontaktieren sie uns für nähere Informationen.

⁸ typischer Wert, abhängig von der WLAN-Infrastruktur

⁹ Energiesparbetrieb

7.1.3 Funkspezifische Daten

Funk-Datenlogger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2001	0572 2002	0572 2003	0572 2004	0572 2005
Funkfrequenz	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)				
Generelle Verschlüsselungsmethode	WEP, WPA (TKIP), WPA2 (TKIP, AES, CCMP)				

Funk-Datenlogger	T1	T2	T3	H1	H2
Bestellnummer	0572 2031	0572 2032	0572 2033	0572 2034	0572 2035
Funkfrequenz	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/x)				
Generelle Verschlüsselungsmethode	WEP, WPA (TKIP), WPA2 (TKIP, AES, CCMP)				
WPA2 Enterprise	EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK				

7.1.4 Technische Vorgaben für ein gesichertes WLAN

Ports

Die testo Saveris 2 Funk-Datenlogger verwenden das Protokoll MQTT, welches über Port TCP 1883¹⁰ oder 8883¹¹ kommunizieren.

Des Weiteren sind diese UDP-Portfreigaben notwendig:

- Port 53 (DNS Namensauflösung)
- Port 123 (NTP Zeitsynchronisation)

Alle Ports müssen nur nach außen in Richtung der Cloud kommunizieren können. Es sind keine bidirektionalen Portfreigaben notwendig.

¹⁰ Für Artikelnummer: 0572 2001, 0572 2002, 0572 2003, 0572 2004, 0572 2005

¹¹ Für Artikelnummer: 0572 2031, 0572 2032, 0572 2033, 0572 2034, 0572 2035

Ping

Das Default-Gateway, welches dem Fühler über DHCP oder manuell mitgeteilt wird, muss auf die PING-Anfrage des Funk-Datenloggers antworten.



Hinweis

Bei der Erst-Konfiguration kann ausgewählt werden, ob DHCP oder Statische IP verwendet werden sollen (Expert-Mode auswählen für die entsprechenden Angaben)

testo Saveris 2-Anwendung

Die testo Saveris 2-Anwendung ist über einen normalen, aktuellen Browser (www) erreichbar. Dafür werden die Standard-TCP-Ports http (80) und https (443) verwendet.

7.1.5 Zulassungen

Bitte beachten Sie die folgenden landesspezifischen Informationen zur Produktzulassung.

7.1.5.1 Europäische Union, EFTA-Staaten

T1 (0572 2001):



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo Saveris 2 – T1

Best. Nr.: / Order No.: 0572 2001

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die **elektromagnetische Verträglichkeit** (2014/30/EU) festgelegt sind.

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC "Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility". The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

For assessment of the product following standards have been called upon:

Standards:

ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012
ETSI EN 301 489-01 V1.9.2: 2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for:

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit
(Name / name)

Uwe Haury
(Name / name)

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Head of Electrical Engineering
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 01.10.2014
(Ort, Datum / place, date)



Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)

(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)

T2 (0572 2002):



Wir messen es. 

EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo Saveris 2 – T2

Best. Nr.: / Order No.: 0572 2002

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die **elektromagnetische Verträglichkeit** (2014/30/EU) festgelegt sind.

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC "Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

For assessment of the product following standards have been called upon:

Standards:

ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012
ETSI EN 301 489-01 V1.9.2: 2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for:

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit
(Name / name)

Uwe Haury
(Name / name)

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Head of Electrical Engineering
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 02.10.2014
(Ort, Datum / place, date)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)




Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

T3 (0572 2003):



Wir messen es. 

EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo Saveris 2 – T3

Best. Nr. / Order No.: 0572 2003

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die **elektromagnetische Verträglichkeit** (2014/30/EU) festgelegt sind.

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC "Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

For assessment of the product following standards have been called upon:

Standards:

ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012
ETSI EN 301 489-01 V1.9.2: 2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for:

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit

(Name / name)

Uwe Haury

(Name / name)

Managing Director

(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Head of Electrical Engineering

(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 02.10.2014

(Ort, Datum / place, date)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)



Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

H1 (0572 2004):



Wir messen es. 

EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo Saveris 2 – H1

Best. Nr.: / Order No.: 0572 2004

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die **elektromagnetische Verträglichkeit** (2014/30/EU) festgelegt sind.

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC "Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

For assessment of the product following standards have been called upon:

Standards:

**ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012
ETSI EN 301 489-01 V1.9.2: 2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012**

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for:

**Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com**

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit
(Name / name)

Uwe Haury
(Name / name)

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Head of Electrical Engineering
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 01.10.2014
(Ort, Datum / place, date)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)




Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

H2 (0572 2005):



Wir messen es. 

EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo Saveris 2 – H2

Best. Nr.: / Order No.: 0572 2005

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die **elektromagnetische Verträglichkeit** (2014/30/EU) festgelegt sind.

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC "Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

For assessment of the product following standards have been called upon:

Standards:

ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012
ETSI EN 301 489-01 V1.9.2: 2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for:

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit
(Name / name)

Uwe Haury
(Name / name)

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Head of Electrical Engineering
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 02.10.2014
(Ort, Datum / place, date)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)


(Rechtsgültige Unterschrift)
(Legally valid signature)



Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

USA / Kanada

Dieses Gerät erfüllt Teil 15C der FCC-Richtlinien und Industrie Canada RSS-210 (Überarbeitung 8). Seine Inbetriebnahme unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen hervorrufen und (2) dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben können.

USA

Contains FCC ID: N8NLSD4WF0459

T1 FCC ID: 2ACVD-05722031

T2 FCC ID: 2ACVD-05722032

T3 FCC ID: 2ACVD-05722033

H1 FCC ID: 2ACVD-05722034

H2 FCC ID: 2ACVD-05722035

T1 FCC ID: WAF-0572203X

T2 FCC ID: WAF-0572203X

T3 FCC ID: WAF-0572203X

H1 FCC ID: WAF-05722034

H2 FCC ID: WAF-0572203X

Canada

Contains IC: 21461-LSD4WF0459

T1 IC: 12231A-05722031

T2 IC: 12231A-05722032

T3 IC: 12231A-05722033

H1 IC: 12231A-05722034

H2 IC: 12231A-05722035

T1 IC: 6127B-0572203X

T2 IC: 6127B-0572203X

T3 IC: 6127B-0572203X

H1 IC: 6127B-05722034

H2 IC: 6127B-0572203X

7.1.5.2 Japan

T1 (0572 2001):  R 204-440017

T2 (0572 2002):  R 204-440018

T3 (0572 2003):  R 204-440019

H1 (0572 2004):  R 204-440020

H2 (0572 2005):  R 204-440021

7.1.5.3 Australien



E 1561

7.1.5.4 China

T1 (0572 2001): CMIIT ID: 2014DP5734

T2 (0572 2002): CMIIT ID: 2014DP5735

T3 (0572 2003): CMIIT ID: 2014DP5736

H1 (0572 2004): CMIIT ID: 2014DP5732

H2 (0572 2005): CMIIT ID: 2014DP5733

7.1.5.5 Korea



Gerätemode II	T1 (2016)	T2 (2016)	T3 (2016)	H1 (2016)	H2 (2016)
Identifikationsnummer	MSIP-CRM-Toi-Saveris2T1	MSIP-CRM-Toi-Saveris2T2	MSIP-CRM-Toi-Saveris2T3	MSIP-CRM-Toi-Saveris2H1	MSIP-CRM-Toi-Saveris2H2
Antragsteller	Testo Instruments (Shenzen) Co., Ltd.				
Hersteller	Testo Instruments (Shenzen) Co., Ltd.				
Herstellungsland	China				
Hinweis	해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음				

7.1.5.6 Russland

Zulassung vorhanden.

7.1.5.7 Chile

Zulassung vorhanden.

7.1.5.8 Singapur

Zulassung vorhanden.

7.1.5.9 Ukraine

Zulassung vorhanden.

7.1.5.10 Vereinigte Arabische Emirate

Zulassung vorhanden.






7.1.6 Zulassungen (2016)

Approval and Certification

Product	Saveris 2 T1 (2016) Saveris 2 T2 (2016) Saveris 2 T3 (2016) Saveris 2 H1 (2016) Saveris 2 H2 (2016)
Mat.-No.	0572 2031 0572 2032 0572 2033 0572 2034 0572 2035
Date	04.05.2017

i The use of the wireless module is subject to the regulations and stipulations of the respective country of use, and the module may only be used in countries for which a country certification has been granted. The user and every owner has the obligation to adhere to these regulations and prerequisites for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. in particular in countries without wireless permits, is his responsibility.

Country	Comments
Canada	Contains IC : 21461-LSD4WF0459 T1, T2, T3, H2: IC: 6127B-0572203X H1: IC: 6127B-05722034 IC Warnings

<p>Europa + EFTA</p>	 <hr/>  <p>The EU Declaration of Conformity can be found on the testo homepage www.testo.com under the product specific downloads.</p> <hr/> <p>EU countries: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY).</p> <p>EFTA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland</p>
<p>Japan</p>	  <p>211-160704</p> <p>Japan Information</p>
<p>South Korea</p>	 <p>T1: MSIP-CRM-te2-05722031 T2: MSIP-CRM-te2-05722032 T3: MSIP-CRM-te2-05722033 H1: MSIP-CRM-te2-05722034 H2: MSIP-CRM-te2-05722035</p> <p>KCC Warning</p>

USA	<p>Contains FCC ID: N8NLS4WF0459</p> <p>T1, T2, T3, H2: FCC ID: WAF-0572203X H1: FCC ID: WAF-05722034</p> <p>FCC Warnings</p>														
Wi-Fi-Module	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 456 624 504">Feature</th> <th data-bbox="624 456 963 504">Values</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 504 624 536">WLAN Range</td> <td data-bbox="624 504 963 536">100 m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 536 624 568">WLAN type</td> <td data-bbox="624 536 963 568">LSD4WF0459-01D0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 568 624 624">WLAN radio class</td> <td data-bbox="624 568 963 624">Accord with the standard of IEEE 802.11b/g/n</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 624 624 655">Company</td> <td data-bbox="624 624 963 655">Lierda Technology Group co., LTD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 655 624 687">RF Band</td> <td data-bbox="624 655 963 687">2412-2472MHz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 687 624 719">Transmitter Power</td> <td data-bbox="624 687 963 719">13.42dBm</td> </tr> </tbody> </table>	Feature	Values	WLAN Range	100 m	WLAN type	LSD4WF0459-01D0	WLAN radio class	Accord with the standard of IEEE 802.11b/g/n	Company	Lierda Technology Group co., LTD	RF Band	2412-2472MHz	Transmitter Power	13.42dBm
Feature	Values														
WLAN Range	100 m														
WLAN type	LSD4WF0459-01D0														
WLAN radio class	Accord with the standard of IEEE 802.11b/g/n														
Company	Lierda Technology Group co., LTD														
RF Band	2412-2472MHz														
Transmitter Power	13.42dBm														
EN 12830	Acc. to EN 12830 -S,T,A,C,D,1, -25...+25°C														

IC Warnings

This instrument complies with Part 15C of the FCC Rules and Industry Canada RSS-210 (revision 8). Commissioning is subject to the following two conditions:

- (1) This instrument must not cause any harmful interference and
- (2) this instrument must be able to cope with interference, even if this has undesirable effects on operation.

Cet appareil satisfait à la partie 15C des directives FCC et au standard Industrie Canada RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et
- (2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui provoqueraient des opérations indésirables.

FCC Warnings

Information from the FCC (Federal Communications Commission)

For your own safety

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

FCC warning statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Japan Information

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

KCC Warning

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

7.2 Sicherheit und Umwelt

7.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse aufweist.
- Verwenden Sie nur für Saveris 2 konfigurierte Zubehörteile und Fühler.
- Auch von den zu messenden Anlagen bzw. dem Messumfeld können Gefahren ausgehen: Beachten Sie bei der Durchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.
- Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern beziehen sich nur auf den Messbereich der Sensorik. Setzen Sie Handgriffe und Zuleitungen keinen Temperaturen über 70 °C (158 °F) aus, wenn diese nicht ausdrücklich für höhere Temperaturen zugelassen sind.
- Führen Sie keine Kontakt-Messungen an nicht isolierten, spannungsführenden Teilen durch.
- Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln. Verwenden Sie keine Trockenmittel.
- Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.

7.2.2 Sicherheitshinweise für Patienten mit einem Herzschrittmacher oder implantiertem Herzschrittmacher

- Handhaben Sie die Magnetplatte des Wandhalters vorsichtig und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort.
- Halten Sie 20 cm Abstand zwischen Ihrem Implantat und der Magnetplatte des Wandhalters.

7.2.3 Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zur Zerstörung der Batterien, Verletzungen durch Stromstöße, Feuer oder zum Auslaufen von chemischen Flüssigkeiten führen.
- Setzen Sie die mitgelieferten Batterien nur entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ein.

- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und modifizieren Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien nicht starken Stößen, Wasser, Feuer oder Temperaturen über 60 °C aus.
- Lagern Sie die Batterien nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit: Waschen Sie die betroffenen Regionen gründlich mit Wasser aus und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Verwenden Sie keine undichten oder beschädigten Batterien.

7.2.4 Umwelt schützen

- Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.


7.3 Wandhalterung



Hinweis

Die Datenlogger dürfen nur senkrecht montiert werden. Dabei müssen die Anschlüsse nach unten gerichtet sein. Bei Datenloggern mit Display müssen Sie die Leserichtung beachten. Andernfalls kann die Messgenauigkeit verfälscht werden.

Die Wandhalterung sorgt für einen sicheren Halt des Funk-Datenloggers. Befestigungsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wählen Sie geeignete Befestigungsmaterialien entsprechend des gewünschten Befestigungsortes.

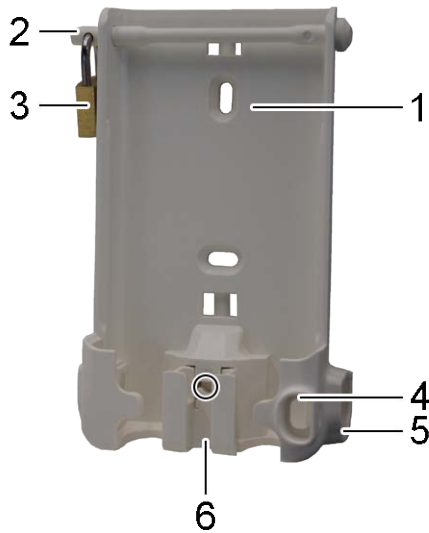

(Verwendbar für: 0527 2001, 0527 2002, 0527 2003, 0527 2004, 0527 2005, 0527 2031, 0527 2032, 0527 2033, 0527 2035)

- 1 Wandhalterung mit Aussparungen für Befestigungsmaterialien (Schrauben oder Kabelbinder)
- 2 Sicherungsbolzen
- 3 Schloss
- 4 Aufbewahrungsfach Verschlussstopfen USB-Buchse
- 5 Aufbewahrungsfach Verschlussstopfen Fühlerbuchse (links / rechts)
- 6 Kabelhalter USB-Kabel, aufklappbar: mit Schraubendreher auf die mit einem Kreis gekennzeichnete Stelle drücken und Kabelhalter nach unten schieben.


(Verwendbar für: 0572 2034)

- 1 Wandhalterung
- 2 Datenlogger
- 3 Entriegelungswerkzeug
- 4 Magnetplatte (optional bestellbar, Bestellnummer: 0554 2001)

- Führen Sie das Entriegelungswerkzeug in die Entriegelungsöffnung ein.
- Ziehen Sie den Datenlogger aus der Wandhalterung nach oben heraus.

7.4 Anzeige- und Bedienelemente



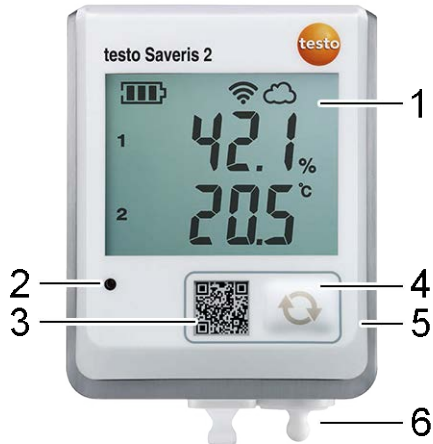



7.4.1 Übersicht



- 1 Display
- 2 Alarm-LED, blinkt bei Alarm rot
- 3 QR-Code, zum direkten Aufruf der Gerätedaten in der Testo-Cloud
- 4 Bedientaste, zum manuellen Start einer Datenübertragung
- 5 Batteriefach (Rückseite)
- 6 USB- und Fühlerbuchsen (Unterseite, gerätespezifisch)

7.4.2 Displaysymbole

Symbol	Beschreibung
	Batteriekapazität 75% ... 100%
	Batteriekapazität 50% ... 74%
	Batteriekapazität 25% ... 49%
	Batteriekapazität 5% ... 24%, Symbol blinkt: Batteriekapazität < 5%
	Externe Stromversorgung (über USB-Buchse)
	WLAN-Signalstärke 100%

Symbol	Beschreibung
	WLAN-Signalstärke 75%
	WLAN-Signalstärke 50%
	WLAN-Signalstärke 25%
	Datenverbindung zur Testo-Cloud besteht, Symbol blinkt: Datenverbindung zur Testo-Cloud wird aufgebaut
	Alarmmeldung
1	Messkanal 1
2	Messkanal 2
	Alarmstatus: Oberer Grenzwert überschritten
	Alarmstatus: Unterer Grenzwert unterschritten

7.4.3 LED-Anzeige – Konfiguration

LED-Anzeige	Beschreibung
Online-Datenlogger blinkt alle 30 sec kurz (200 ms) grün.	Online-Datenlogger befindet sich im Standby Modus, es ist noch keine Konfiguration im Online-Datenlogger hinterlegt.
Online-Datenlogger blinkt im Sekundentakt grün.	Online-Datenlogger befindet sich im Konfigurationsmodus und kann innerhalb von 5 min nach Aktivierung konfiguriert werden.
Online-Datenlogger blinkt nach Konfiguration 3 Mal lang rot.	SSID/Account ID ist nicht korrekt.
Online-Datenlogger blinkt 1 Mal lang (1 sec) rot.	Online-Datenlogger wurde nicht innerhalb von 5 min konfiguriert.
Online-Datenlogger blinkt nach der Konfiguration 2 Mal lang rot.	Online-Datenlogger hat keine Verbindung zum Access Point.
Online-Datenlogger blinkt 2 Mal kurz grün.	Konfiguration war erfolgreich, Online-Datenlogger ist mit der Cloud verbunden und wechselt in Messmodus.

7.4.4 LED-Anzeige – Betrieb

LED-Anzeige	Beschreibung
Bereits konfigurierter Online-Datenlogger blinkt 2 Mal kurz rot.	Online-Datenlogger hat keine Verbindung zum Access Point, Messdaten können nicht in die Cloud übertragen werden.
Online-Datenlogger blinkt 1 Mal lang grün.	Der Online-Datenlogger hat eine Messung ausgeführt.
Online-Datenlogger blinkt 1 Mal lang rot.	Ein Alarm wurde durch den Online-Datenlogger detektiert.
Online-Datenlogger blinkt 2 Mal kurz grün.	Messdaten wurden erfolgreich in die Cloud übertragen, Logger befindet sich wieder im Messzyklus.
Online-Datenlogger blinkt 4 Mal lang rot.	Drücken Sie kurz (< 1 sec) die Taste an der Vorderseite des Loggers. Blinkt der Online-Datenlogger erneut 4 Mal rot, sind die Batterien verbraucht und müssen gewechselt werden.
Online-Datenlogger blinkt abwechselnd rot / grün.	Es wird ein Firmware Update durchgeführt.

8 Benutzeroberfläche

The screenshot shows the testo Saveris 2 web interface. At the top, a dark header bar contains the logo, system status, and user information. Below this is a navigation bar with menu items. The main content area is divided into two columns: 'Messstellen' (Measurement Stations) and 'Aktive Alarmer' (Active Alarms). The 'Messstellen' section includes a table of stations and a detailed view for station H2_45800848. The 'Aktive Alarmer' section shows a warning for station H2_45800848. Numbered callouts 1-5 point to specific UI elements: 1 (System status), 2 (User profile), 3 (User name), 4 (Navigation bar), and 5 (Main content area).

1 System- und Statusinformationen (siehe Seite 48)

2 Befehlsleiste (siehe Seite 47)

3 Benutzerverwaltung (siehe Seite 46)

4 Menüleiste mit den Hauptmenüs:

- Dashboard (siehe Seite 36)
- Analyse & Berichte (siehe Seite 36)
- Alarmer (siehe Seite 38)
- Konfiguration (siehe Seite 41)

5 Anzeigebereich


- 1 System- und Statusinformationen (siehe Seite 48)
- 2 Befehlsleiste (siehe Seite 47)
- 3 Benutzerverwaltung (siehe Seite 46)
- 4 Menüleiste mit den Hauptmenüs:
 - Dashboard (siehe Seite 36)
 - Analyse & Berichte (siehe Seite 36)
 - Alarmer (siehe Seite 38)
 - Konfiguration (siehe Seite 41)
- 5 Anzeigebereich

9 Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite. Sie bietet eine Übersicht über die wichtigsten Systemdaten: **Messstellen** und **Aktive Alarme**.


9.1 Messstellen

Kurzinformationen zu allen Messstellen werden angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol , um weitere Informationen anzuzeigen.

9.2 Aktive Alarme

Kurzinformationen zu allen aktiven Alarmen und Systemwarnungen werden angezeigt. Ungelesene Alarme und Systemwarnungen werden **fett** dargestellt.

Klicken Sie auf das Symbol , um weitere Informationen anzuzeigen.

Mit Anzeigen der Detailinformationen wird die Alarmmeldung / Systemwarnung als "gelesen" gekennzeichnet und der Alarmzähler wird heruntergesetzt.

10 Analyse & Berichte

10.1 Automatische Berichte

Automatische Berichte werden regelmäßig automatisch vom System generiert (Generierte Berichte), entsprechend der durch den Benutzer festgelegten Einstellungen (Berichtseinstellungen).

Erstellen eines Automatischen Berichts

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatischen Bericht erstellen**.
2. Geben Sie die erforderlichen Daten zur Erstellung des Automatischen Berichts ein.


Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:

- **Name des Berichts:** Bezeichnung des Automatischen Berichts.
- **Messstellen für den Bericht:** Messstellen, die im Bericht erfasst werden sollen. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor der Kanal-Bezeichnung.
- **Wie oft soll der Bericht erstellt werden?:** Zeittakt, in dem die Berichte generiert werden sollen. Wählen Sie einen Berichtstakt aus dem Ausklappmenü.
- **Dateiformat:** Dateiformat, in dem die Berichte generiert werden sollen. Wählen Sie ein Dateiformat aus dem Ausklappmenü.

- **Datenansichten:** Datenansichten, in der die Daten im Berichte dargestellt werden sollen. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor der Datenansicht-Bezeichnung.
 - **Report zusätzlich per E-Mail versenden:** Berichte können zusätzlich zum Speichern unter **Generierte Berichte** als E-Mail versendet werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Eingabemaske für E-Mail-Adressen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatischen Bericht anlegen**.
Der erste Bericht wird am darauffolgenden Tag erstellt.

Generierte Berichte

Kurzinformationen zu bereits generierten Berichten werden angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol , um weitere Informationen anzuzeigen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**, um einen Bericht herunterzuladen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diese Berichtsserie bearbeiten**, um die Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.

Berichtseinstellungen

Bereits angelegte Automatische Berichte werden in einer Tabelle angezeigt.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und anschließend auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und anschließend auf **Löschen**, um den Automatischen Bericht zu löschen.

11 Alarme

11.1 Alarmliste


Anzeige von Alarmen

Kurzinformationen zu allen aufgetretenen Alarmen und Systemwarnungen werden angezeigt. Ungelesene Alarme und Systemwarnungen werden **fett** dargestellt.

Die Anzeige kann nach folgenden Eigenschaften gefiltert werden:

- Nach Messstellen-Gruppe / Messstelle: Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor der Messstellen-Gruppe / der Messstelle.
- Nach Datum / Uhrzeit: Klicken Sie auf das Start-Datum / Ende-Datum und wählen Sie Start-Datum / Startzeit und Ende-Datum / Ende-Zeit.

Detailinformationen zu Alarmen

Klicken Sie auf das Symbol , um weitere Informationen anzuzeigen.

Mit Anzeigen der Detailinformationen wird die Alarmmeldung / Systemwarnung als "gelesen" gekennzeichnet und der Alarmzähler wird heruntergesetzt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle als gelesen kennzeichnen**, um alle Alarmmeldungen als "gelesen" zu kennzeichnen.

11.2 Alarmeinstellungen

Alarmeinstellungen erstellen und anzeigen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Neue Alarmeinstellung**, um eine neue Alarmeinstellung zu erstellen.

Bereits vorhandene Alarmeinstellungen werden unter der Schaltfläche angezeigt.

- Klicken Sie auf den Titel einer Alarmeinstellung, um diese anzuzeigen.

Angezeigte Alarmeinstellung konfigurieren und bearbeiten

Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:

- **Titel:** Bezeichnung der Alarmeinstellung (Pflichtfeld).
- **Messstellen:** Messstellen-Gruppe / Messstelle, die überwacht werden soll. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor der Messstellen-Gruppe / der Messstelle.
- **Alarmgrenzwert 1 und 2:** verschiedene Grenzwertbereiche die für unterschiedliche Zeiträume definiert werden können.
- **Untere Grenze, Obere Grenze-**sind Werte, die überwacht werden sollen.

- **Verzögerung des Alarms:** Mindestdauer einer Grenzwertverletzung bevor eine Alarmierung stattfindet.



Die Zeitabstände zwischen den Messungen (Messtakt) sollte geringer sein als die Verzögerung des Alarms (Bsp.: Messtakt = 5 Minuten, Verzögerung des Alarms = 15 Minuten).

- **Zeitsteuerung:** Definieren Sie hier individuelle Alarmzeiträume für die Alarmgrenzwerte 1 und 2 oder kein Alarmgrenzwert gelten soll. Für die Festlegung von Alarmgrenzwert 1 und 2 klicken Sie doppelt auf einen Zeitpunkt in der Tabelle oder ziehen Sie den gewünschten Zeitbereich mit der Maus auf. In Zeiträumen, die in der Tabelle frei gelassen werden, erhalten Sie keine Alarmierung.



Wenn keine Alarmzeiträume definiert werden, sind die Alarmgrenzen 24 Stunden am Tag aktiv.

Wenn Alarmzeiträume definiert werden, sind die Grenzwertalarme ausschließlich im markierten Zeitraum aktiv.

- **Kanalalarne:** Alarmierung bei defektem Sensor.
- **E-Mail-Empfänger:** Adressaten, die beim Auftreten eines Alarms informiert werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor dem Empfänger oder geben Sie Name und E-Mail-Adresse weiterer Empfänger ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Hinzufügen**.
- **SMS-Empfänger:** Adressaten, die beim Auftreten eines Alarms informiert werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor dem Empfänger oder geben Sie Name und Mobilfunknummer weiterer Empfänger ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Hinzufügen**.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.
- **Löschen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Alarmeinstellung zu löschen.

11.3 Systemwarnungen

Systemwarnungen erstellen und anzeigen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Neue Systemwarnung**, um eine neue Systemwarnung zu erstellen.

Bereits vorhandene Systemwarnungen werden unter der Schaltfläche angezeigt.

- Klicken Sie auf den Titel einer Systemwarnung, um diese anzuzeigen.

Angezeigte Systemwarnung konfigurieren und bearbeiten

Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:

- **Titel:** Bezeichnung der Systemwarnung (Pflichtfeld).
- **Batterie fast leer:** Überwachung des Funk-Datenloggers auf leere Batterie.
- **Stromversorgung unterbrochen:** Überwachung der externen Stromversorgung des Funk-Datenloggers auf Unterbrechungen.
- **Funk-Datenlogger meldet sich nicht mehr:** Überwachung des Funk-Datenloggers auf ausbleibende Datenübermittlung. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren** und stellen Sie den Überwachungstakt mit dem Schieberegler ein.



Hinweis

Die eingestellte Zeit sollte größer sein als der Kommunikationstakt des Funk-Datenloggers.

- **Funk-Datenlogger:** Messstellen-Gruppe / Messstelle, die überwacht werden soll. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor der Messstellen-Gruppe / der Messstelle.
- **E-Mail-Empfänger:** Adressaten, die beim Auftreten eines Alarms informiert werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor dem Empfänger oder geben Sie Name und E-Mail-Adresse weiterer Empfänger ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Hinzufügen**.
- **SMS-Empfänger:** Adressaten, die beim Auftreten eines Alarms informiert werden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen vor dem Empfänger oder geben Sie Name und Mobilfunknummer weiterer Empfänger ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Hinzufügen**.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.
- **Löschen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Systemwarnung zu löschen.

12 Konfiguration

12.1 Benutzer

Benutzer können angelegt und verwaltet werden.

Standard-Benutzer

Standardmäßig werden zwei Benutzer im System angelegt:

- Account Owner (Name kann geändert werden), mit Benutzerrolle Administrator (Rolle kann nicht geändert werden).
- Support Testo (Name kann geändert werden), mit Benutzerrolle Testo-User-Support (Rolle kann nicht geändert werden).

Neue Benutzer anlegen und bearbeiten

Weitere Benutzer mit unterschiedlichen Benutzerrollen (siehe Seite 42) können angelegt und bearbeitet werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Benutzer anlegen**, um einen neuen Benutzer anzulegen.

Bereits vorhandene Benutzer werden in einer Liste angezeigt.

- Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers, um die Einstellungen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.

Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:

- **Titel:** Bezeichnung des Benutzers.
- **Vorname:** Vorname des Benutzers (Pflichtfeld).
- **Zweitname:** Zweitname des Benutzers.
- **Nachname: Nachname des Benutzers (Pflichtfeld).**
- **Passwort und Passwort wiederholen:** Benutzerpasswort. Das Benutzerpasswort, kann durch den Benutzer nachträglich geändert werden.
- **Benutzerrolle:** Definiert die Rechte des Benutzers im System.
- **E-Mail-Adresse & Anmeldung:** E-Mail-Adresse des Benutzers. Die E-Mail-Adresse ist gleichzeitig der Anmelde-name. Die E-Mail-Adresse wird auch für Systembenachrichtigungen (Alar-me, Systemwarnungen) verwendet.
- **E-Mail-Adresse & Anmeldung ändern (Feld ist nur beim Bearbeiten des Benutzerkontos des Konto-Besitzers verfügbar):** Geben Sie eine neue E-Mail-Adresse ein. Bei Eingabe einer neuen E-Mail-Adresse ändert sich auch der Anmelde-name.

- **Mobilnummer:** Telefonnummer des Benutzers, diese wird für Systembenachrichtigungen (Alarmer und Systemwarnungen) verwendet.
- **Aktiv von:** Datum, ab dem der Benutzer aktiv ist.
- **Aktiv bis:** Datum, bis zu dem der Benutzer aktiv ist.
- **Details:** Textfeld zur Eingabe von weiteren benutzerspezifischen Informationen.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.

12.2 Benutzerrollen

Eine Beschreibung der verfügbaren Benutzerrollen kann angezeigt werden.

- Klicken Sie auf den Titel einer Benutzerrolle, um deren Beschreibung anzuzeigen.

Benutzer besitzen, abhängig von der zugewiesenen Benutzerrolle, unterschiedliche Berechtigungen:

Berechtigungen	Administrator	Analyst	Auditor	Operator
Angelegte Benutzer anzeigen	x	x	x	x
Benutzer anlegen, bearbeiten und löschen	x	-	-	-
Account ID anzeigen	x	-	-	x
Funk-Datenlogger anmelden	x	-	-	x
Funk-Datenlogger konfigurieren und deaktivieren	x	-	-	x
Bereiche anlegen, bearbeiten und löschen	x	-	-	x
Alarminstellungen und Systemwarnungen anzeigen, anlegen, bearbeiten und löschen	x	-	-	x
Messwerte lesen und analysieren	x	x	x	x
Details zu Alarmen und Systemwarnungen anzeigen (= Alarme und Systemwarnungen als gelesen markieren)	x	x	x	x
Automatische Berichte erstellen	x	-	-	x

x = verfügbar, - = nicht verfügbar

12.3 Account ID

Die Account ID ist die eindeutige Adresse Ihres Nutzerkontos in der Testo-Cloud. Sie wird zur Konfiguration der Funk-Datenlogger benötigt, damit diese Ihre Daten an das korrekte Nutzerkonto senden.

12.4 Messstellengruppen

Messstellen können in Messstellengruppe organisiert werden.

Die Zuordnung von Messstellen zu einer Messstellengruppe (z. B. Raum 1, Raum 2, ...) erleichtert die Verwaltung mehrerer Messstellen.

Für eine übergeordnete Gruppierung können Messstellen-Gruppen einem Bereich (z. B. Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, ...) zugeordnet werden. Siehe auch Bereiche, Seite **44**.

Messstellengruppe erstellen und bearbeiten

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Messstellengruppe**, um eine neue Messstellengruppe zu erstellen.

Bereits erstellte Messstellengruppen werden in einer Liste angezeigt.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und anschließend auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten. Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:
 - **Titel:** Bezeichnung der Messstellengruppe (Pflichtfeld).
 - **Beschreibung:** Beschreibung der Messstellengruppe.
 - **Bereich:** Bereich, dem die Messstellengruppe zugeordnet werden soll.
 - **Messstellen:** Verfügbare und der Messstellengruppe zugewiesene

Messstellen werden angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol , um eine Messstelle der Gruppe zuzuweisen. Klicken Sie auf das Symbol



, um eine Messstelle aus der Gruppe zu löschen.

- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.
- **Löschen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Messstellengruppe zu löschen.

Messstellengruppe löschen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und anschließend auf **Löschen**, um die Messstellengruppe zu löschen.

12.5 Bereiche

Messstellengruppen können in Bereichen organisiert werden.

Die Zuordnung von Messstellengruppen zu einem Bereich (z. B. Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, ...) erleichtert die Verwaltung mehrerer Messstellengruppen. Siehe auch Messstellengruppen, Seite 43.

Bereich erstellen und bearbeiten

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Bereich**, um einen neuen Bereich zu erstellen.

Bereits erstellte Bereiche werden in einer Liste angezeigt.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und anschließend auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.

Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:

- **Anzeigename:** Bezeichnung des Bereichs (Pflichtfeld).
- **Beschreibung:** Beschreibung des Bereichs.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.
- **Löschen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Bereich zu löschen.

Bereich löschen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen** und anschließend auf **Löschen**, um den Bereich zu löschen.

12.6 Funk-Datenlogger

Kurzinformationen zu allen angemeldeten Funk-Datenlogger werden angezeigt.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Details**, um weitere Informationen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Deaktivieren** bzw. **Aktivieren**, um Funk-Datenlogger zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.

Funk-Datenlogger konfigurieren

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**, um die Konfiguration zu ändern.

Folgende Einstellungen können definiert und bearbeitet werden:

- **Name des Funk-Datenloggers:** Bezeichnung des Funk-Datenloggers (Pflichtfeld). Auslieferungszustand: **Modell_Seriennummer**
- **Beschreibung:** Beschreibung des Funk-Datenloggers.

- **Batterietyp wählen:** Einstellen des verwendeten Batterietyps. Für eine korrekte Anzeige der Batteriekapazität muss der Batterietyp korrekt ausgewählt werden.
- **Display:** Display des Funk-Datenloggers ein- oder ausschalten.
- **Name der Messstelle:** Bezeichnung der Messstelle (Pflichtfeld).
- **Messtakt:** Zeittakt, in dem Messwerte ermittelt werden. Stellen Sie den Messtakt mit dem Schieberegler ein.
- **Tages-Kommunikationstakt** und **Nacht-Kommunikationstakt:** Zeittakt, in dem Messwerte an die Testo-Cloud übermittelt werden. Wählen Sie die Startzeit des Tages-Kommunikationstakts und des Nacht-Kommunikationstakts. Stellen Sie den Kommunikationstakt mit dem Schieberegler ein.
- **Kanalname:** Bezeichnung des Messkanals (Pflichtfeld). Auslieferungszustand: **Modell_Seriennummer_Kanalnummer**
- **Einheit auswählen:** Einheit, in der die Messwerte angezeigt werden.
- **Sensortyp auswählen** (nur bei Modell T2, T3): Sensortyp, der vom Messkanal verwendet wird.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.
- **Deaktivieren** bzw. **Aktivieren:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Messkanäle bzw. Funk-Datenlogger zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
- **Entfernen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Funk-Datenlogger vom System abzumelden.

12.7 Firmware Updates

Eine Liste mit verfügbaren Firmware Updates für die Funk-Datenlogger wird angezeigt. Firmware Updates können über Funk auf die Datenlogger aufgespielt werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**, um ein Firmware Update zu installieren.

13 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung bietet Informationen und Einstellmöglichkeiten zum Benutzerkonto.

- Klicken Sie auf das Symbol , um das **Benutzermenü** zu öffnen.

13.1 Benutzereinstellungen

Benutzerspezifische Einstellungen können vorgenommen werden.

- **Sprache:** Sprache der Bedienoberfläche wählen.
- **Zeitzone:** Zeitzone für die Anzeige von Datum und Uhrzeit wählen.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.

13.2 Kontoinformationen

Informationen zu Ihrem Saveris 2-Konto werden angezeigt.

13.3 Passwort ändern

Das Benutzerpasswort kann geändert werden.

- **Neues Passwort** und **Neues Passwort (wiederholen):** Neues Passwort in beide Textfelder eingeben.
- **Speichern:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.



Hinweis

Eine Änderung des Benutzernamens (E-Mail-Adresse) ist nicht möglich.

13.4 Abmelden

Der Benutzer wird vom System abgemeldet.

- **Abmelden:** Klicken Sie auf den Text, um sich abzumelden.

14 Befehlsleiste

14.1 Quick Start Guide öffnen

Der Quick Start Guide unterstützt Sie beim Anmelden von Funk-Datenloggern.

- Klicken Sie auf das Symbol , um den **Quick Start Guide** zu öffnen.


14.2 Online Hilfe öffnen

Die Online Hilfe (dieses Dokument) unterstützt bei Fragen zu den Produktkomponenten.

- Klicken Sie auf das Symbol , um die **Online Hilfe** zu öffnen.

14.3 Systemnachrichten öffnen

Die Systemnachrichten enthalten wichtige Mitteilungen zum Produkt.

- Klicken Sie auf das Symbol , um die **Systemnachrichten** zu öffnen. Die Anzahl nicht gelesener Systemnachrichten wird über dem Symbol angezeigt.

Kurzinformationen zu allen Systemnachrichten werden angezeigt.
Ungelesene Systemnachrichten werden **fett** dargestellt.

- Klicken Sie auf den Titel einer Systemnachricht, um weitere Informationen anzuzeigen.

Mit Anzeigen der Detailinformationen wird die Systemnachricht als "gelesen" gekennzeichnet und der Nachrichtenzähler wird heruntergesetzt.

15 System- und Statusinformationen

15.1 Systemstatus anzeigen

Zeigt den Alarmstatus an.



: Keine Alarme vorhanden



: Alarme vorhanden, Anzahl der ungelesenen Alarme wird angezeigt

- Klicken Sie auf das Symbol, um die **Alarmliste** zu öffnen.

16 Häufig gestellte Fragen

Kann der Funk-Datenlogger mit einem beliebigen USB-Kabel an den PC angeschlossen werden?

Verwenden Sie am besten das mit dem Funk-Datenlogger mitgelieferte USB-Kabel, um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten. Längere USB-Kabel sind nur für die Stromversorgung geeignet.

Kann der Funk Datenlogger auch in Netzwerken mit WPA2 Enterprise Verschlüsselungen eingesetzt werden?

Saveris 2 Logger der zweiten Generation* können in Netzwerken mit folgenden WPA2 Enterprise Verschlüsselungen eingesetzt werden.

EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PAP0-

MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK

Um die Logger in das WPA2 Enterprise Netzwerk einzubinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die auf dem Logger abgelegte .PDF Datei und generieren Sie durch schrittweise Auswahl der Programmiermöglichkeiten eine entsprechende .XML Datei.
2. Kopieren Sie Ihre firmenspezifischen WPA2 Enterprise Zertifikate sowie die generierte .XML Datei über USB per Drag & Drop auf den Massenspeicher des Loggers.
3. Bitte achten Sie bei den Zertifikatsnamen auf die korrekte Schreibweise und Endung.

ca.pem, client.pem, private.key

Überprüfen Sie ob das Zertifikat im Format PEM oder BASE64 vorliegt. Dabei öffnen Sie das Zertifikat mit einem Texteditor und prüfen ob der Text „-----BEGIN CERTIFICATE-----“, lesbar ist. Ist der String nicht lesbar, muss die IT oder der Benutzer das Zertifikat explizit mit BASE64 aus dem Radius Server exportieren oder mit openssl umwandeln. Es darf sich nur ein Zertifikat in der

Datei befinden, kein bundle.

4. Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration des Funkdatenloggers erst nach Entfernen des USB Steckers vollständig übernommen wird.

* Artikelnummer: 0572 2031, 0572 2032, 0572 2033, 0572 2034, 0572 2035

Die XML-Konfigurationsdatei wird vom Funk-Datenlogger nicht übernommen, was kann ich tun?

Abhängig vom Betriebssystem kann es Schwierigkeiten bei der Datenübernahme geben, wenn der Dateiname der Konfigurationsdatei geändert wurde. Belassen Sie den voreingestellten Dateinamen.

Die Funkverbindung des Funk-Datenloggers zum Zugangspunkt ist unterbrochen, was kann ich tun?

- Drücken Sie die Bedientaste am Funk-Datenlogger, um den Suchlauf nach einer WLAN-Verbindung manuell zu starten.
- Ändern Sie die Ausrichtung oder Position des Funk-Datenloggers oder des Zugangspunkts (WLAN-Router).

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E03, E04, E05 oder E09 an, was kann ich tun?

Es ist ein Fehler im Funk-Datenlogger aufgetreten. Der Fehler wird durch die Firmware des Funk-Datenloggers automatisch korrigiert. Der Fehlercode sollte nach wenigen Sekunden nicht mehr angezeigt werden, Sie müssen nichts tun.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E12 an, was kann ich tun?

Die Konfigurations-Datei **WifiConfig.xml** weist einen Fehler auf. Erzeugen Sie mit dem **Quick Start Guide** eine neue Konfigurations-Datei und speichern Sie diese auf dem Funk-Datenlogger. <

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E20 an, was kann ich tun?

Es soll eine WPA2 Enterprise EAP Verbindung konfiguriert werden, es konnte aber kein CA-Zertifikat gefunden werden. Ein CA-Zertifikat ist zwingend notwendig.

Speichern Sie das CA-Zertifikat, PEM Format unter dem Namen „ca.pem“ zusammen mit der XML Datei ab bzw. laden Sie es im Webconfig mit hoch.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E21 an, was kann ich tun?

Das Format des Zertifikat ca.pem ist falsch. Überprüfen Sie, ob das Zertifikat ca.pem im Format PEM oder BASE64 vorliegt. Dabei öffnen Sie das Zertifikat mit einem Texteditor und prüfen ob der Text „-----BEGIN CERTIFICATE-----“, lesbar ist. Ist der String nicht lesbar, muss die IT oder der Benutzer das Zertifikat explizit mit BASE64 aus dem Radius Server exportieren oder mit openssl umwandeln. Es darf sich nur ein Zertifikat in der Datei befinden, kein Bundle.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E22 an, was kann ich tun?

Es soll eine WPA2 Enterprise EAP-TLS Verbindung konfiguriert werden, es konnte aber kein User Zertifikat gefunden werden. Speichern Sie das User Zertifikat im PEM Format unter dem Namen „client.pem“ zusammen mit der XML Datei ab bzw. laden Sie es im Webconfig mit hoch.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E23 an, was kann ich tun?

Das Format des User Zertifikat client.pem ist falsch. Überprüfen Sie, ob das User Zertifikat client.pem im Format PEM oder BASE64 vorliegt. Dabei öffnen Sie das Zertifikat mit einem Texteditor und prüfen ob der Text „-----BEGIN CERTIFICATE-----“, lesbar ist. Ist der String nicht lesbar muss die IT oder Benutzer das Zertifikat explizit mit BASE64 aus dem Radius Server exportieren oder mit openssl umwandeln. Es darf sich nur ein Zertifikat in der Datei befinden, kein Bundle.



Saveris2 Logger der alten Generation vor 2016 (siehe Typenschild):

Häufigste Ursache für diesen Fehler ist eine zu geringe Batteriespannung. Setzen Sie neue Batterien in den Funk-Datenlogger ein.

Wenn dies nicht zum Erfolg führt: Setzen Sie den Funk-Datenlogger in den Auslieferungszustand zurück. Halten Sie dazu die Bedientaste für > 20 s gedrückt, bis das Display erlischt.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E24 an, was kann ich tun?

Es soll eine WPA2 Enterprise EAP-TLS Verbindung konfiguriert werden, es konnte aber kein privat key gefunden werden. Speichern Sie den privat key im PEM Format unter dem Namen „private.key“ zusammen mit der XML Datei ab bzw. laden Sie es im Webconfig mit hoch.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E25 an, was kann ich tun?

Das Format des Zertifikat private.key ist falsch. Überprüfen Sie, ob der private.key im Format PEM oder BASE64 vorliegt. Dabei öffnen Sie das Zertifikat mit einem Texteditor und prüfen ob der Text „-----BEGIN CERTIFICATE-----“, lesbar ist. Ist der String nicht lesbar muss die IT oder Benutzer das Zertifikat explizit mit BASE64 aus dem Radius Server exportieren oder mit openssl umwandeln. Es darf sich nur ein Zertifikat in der Datei befinden, kein Bundle.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E26 an, was kann ich tun?

Für diesen Fehler gibt es 3 mögliche Ursachen:

- 1 Der Zugangspunkt (WLAN-Router) ist außerhalb der Funk-Reichweite oder ausgeschaltet. Prüfen Sie, ob der Zugangspunkt verfügbar ist. Ändern Sie bei Bedarf den Standort des Funk-Datenloggers.

- 2 Der im Funk-Datenlogger gespeicherte Netzwerkname (SSID) ist nicht korrekt. Überprüfen Sie den Netzwerknamen des WLAN-Netzwerks. Erzeugen Sie mit dem **Quick Start Guide** eine neue Konfigurations-Datei mit korrektem Netzwerknamen und speichern Sie diese auf dem Funk-Datenlogger.
- 3 Der Zugangspunkt des WLAN-Netzwerks nutzt nicht eine der folgenden Verschlüsselungsmethoden: WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES, CCMP). Konfigurieren Sie den Zugangspunkt so, dass eine der unterstützten Verschlüsselungsmethoden verwendet wird.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E32 an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger hat keine IP-Adresse erhalten. Für diesen Fehler gibt es 2 mögliche Ursachen:

- 1 Das Netzwerk-Passwort ist falsch. Überprüfen Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks. Erzeugen Sie mit dem **Quick Start Guide** eine neue Konfigurations-Datei mit korrektem Passwort und speichern Sie diese auf dem Funk-Datenlogger.
- 2 Der Zugangspunkt (WLAN-Router) verfügt über einen MAC-Filter oder läßt die Integration neuer Geräte nicht zu. Prüfen Sie die Einstellungen des Zugangspunkts.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E35 an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger hat auf seinen Test-Ping keine Antwort des Zugangspunkts (WLAN-Router) erhalten. Stellen Sie sicher, dass innerhalb der Zugangspunkt-Konfiguration ein Ping auf das Gateway zugelassen wird.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E36 an, was kann ich tun?

Die DNS konnte nicht aufgelöst werden:

- 1 Der Zugangspunkt (WLAN-Router) verfügt über keine Verbindung zum Internet. Prüfen Sie die Internetverbindung des Zugangspunkts.
oder
- 2 Das Routing innerhalb der Netzwerkinfrastruktur funktioniert nicht. Prüfen Sie, ob zu viele Endgeräte am Zugangspunkt angemeldet sind.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E41 an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger kann keine aktuelle Zeit von einem Zeitserver (pool.ntp.org) beziehen.

- 1 Der Zugangspunkt (WLAN-Router) verfügt über keine Verbindung zum Internet. Prüfen Sie die Internetverbindung des Zugangspunkts.
- 2 Der NTP Port (123/UDP) des Zugangspunkts (WLAN-Router) ist nicht offen. Prüfen Sie, ob der NTP Port (123/UDP) geöffnet ist.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E51 an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger konnte sich nicht mit der Testo-Cloud verbinden.

- 1 Wenn der Funk-Datenlogger bereits mit der Testo-Cloud verbunden war und diese Verbindung plötzlich nicht mehr möglich ist: Die Server der Testo-Cloud sind aktuell nicht erreichbar. Die Server werden überwacht und sollten innerhalb weniger Stunden wieder erreichbar sein.
- 2 Wenn der Funk-Datenlogger noch nicht mit der Testo-Cloud verbunden war: Die TCP-Ports (1883 oder 8883) des Zugangspunkts (WLAN-Router) ist nicht offen. Prüfen Sie, ob die TCP-Ports (1883 oder 8883) in beide Richtungen geöffnet ist.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E52 an, was kann ich tun?

Der Datenlogger konnte sich nicht bei der Cloud registrieren weil er bereits in einem anderen Account registriert ist. Bitte melden sie den Datenlogger zuerst in dem bisherigen Account ab.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E63 an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger konnte keine Daten an die Testo-Cloud senden.

- 1 Die Internetverbindung wurde während des Sendevorgangs unterbrochen. Prüfen Sie, ob eine stabile Verbindung vom Funk-Datenlogger zum Zugangspunkt (WLAN-Router) besteht. Prüfen Sie die Internetverbindung des Zugangspunkts. Die Daten werden mit dem nächsten Kommunikationstakt übertragen. Alternativ: Datenübertragung durch Drücken der Bedientaste am Funk-Datenlogger manuell anstoßen.
- 2 Die Server der Testo-Cloud konnten die Anfrage zur Datenspeicherung nicht bearbeiten. Die Server werden überwacht und sollten innerhalb weniger Stunden wieder erreichbar sein.

Der Funk-Datenlogger zeigt den Fehlercode E75 an, was kann ich tun?

Ein Firmware-Update des Funk-Datenloggers ist fehlgeschlagen.

Die Internetverbindung wurde während des Sendevorgangs unterbrochen oder die Daten sind aus sonstigen Gründen nicht unversehrt auf dem Funk-Datenlogger angekommen. Prüfen Sie, ob eine stabile Verbindung vom Funk-Datenlogger zum Zugangspunkt (WLAN-Router) besteht. Prüfen Sie die Internetverbindung des Zugangspunkts. Die Daten werden mit dem nächsten Kommunikationstakt übertragen. Alternativ: Datenübertragung durch Drücken der Bedientaste am Funk-Datenlogger manuell anstoßen.

Der Funk-Datenlogger zeigt die Meldung Err AccountID an, was kann ich tun?

Die in der Konfigurations-Datei enthaltene AccountID ist nicht gültig.

Erzeugen Sie mit dem **Quick Start Guide** eine neue Konfigurations-Datei und speichern Sie diese auf dem Funk-Datenlogger.

Der Funk-Datenlogger zeigt die Meldung no AccountID an, was kann ich tun?

In der Konfigurations-Datei ist keine AccountID vorhanden.

Erzeugen Sie mit dem **Quick Start Guide** eine neue Konfigurations-Datei und speichern Sie diese auf dem Funk-Datenlogger.

Der Funk-Datenlogger zeigt die Meldung no License an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger kann nicht angemeldet werden, weil die Anzahl anmeldbarer Funk-Datenlogger überschritten ist oder Ihre testo Saveris 2-Lizenz abgelaufen ist.

Melden Sie einen anderen Funk-Datenlogger ab, erweitern Sie Ihre testo Saveris 2-Lizenz bzw. erneuern Sie Ihre testo Saveris 2-Lizenz.

Der Funk-Datenlogger zeigt die Meldung not Active an, was kann ich tun?

Der Funk-Datenlogger wurde deaktiviert. Er speichert und sendet deshalb keine Messdaten an die Testo-Cloud.

Aktivieren Sie den Funk-Datenlogger (unter **Konfiguration --> Funk-Datenlogger**), wenn der Funk-Datenlogger wieder Messdaten speichern und senden soll.

17 Änderungshistorie

Informationen zu Änderungen in der testo Saveris 2 Cloud:

Revision	Release date	Improvements
10351	2015-03-26	<ul style="list-style-type: none">• Automatic reports can now be created• Vertical help lines in the PDF report were optimized• SMS alarms can now be sent in Russian, Japanese, Chinese and Turkish.• New users will with immediate effect be created as standard in the language of the account owner• Measurement values were sometimes shown in the report with two decimal places, although the data logger only allows one decimal place maximum. This has been adapted in the reports• Several design errors in the web presentation have been rectified.• Deleting an alarm setting for individual channels/measurement locations from a T3 and T2 no longer deletes both channels.• Internal errors on the web application are

Revision	Release date	Improvements
		<p>now presented in a uniform way.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errors with several users with different languages have been rectified. • Only the most current Firmware version is shown per logger type, including the status • Periods of unrestricted length can now be selected in graph and reports, independently of the selected measurement rate • Settings for day/night communication rate are now checked for plausibility • An error in the representation of units in the CSV report has been rectified • The user settings for the account owner have been corrected. • The time selection in the analysis area has been improved with regard to the use of the Japanese language and the use of Internet Explorer 8 • The switchover of a T2 channel from temperature to door contact has been improved • The texts for e-mail and SMS alarms have been revised • The stability of communication between the probes and the Cloud has been improved • The special symbols "" _ "" and spaces can now be used for naming alarms • The dew point and absolute humidity channels can be deactivated • The input of mobile phone numbers for SMS alarms is now presented more clearly • The presentation of all texts in the web presentation is now uniform • The presentation of the system warning settings "Battery almost discharged" and "Power supply interrupted" have been adapted • The presentation of the data in the data analysis and the reports have been aligned

Revision	Release date	Improvements
		<ul style="list-style-type: none"> • The presentation of deregistered WiFi data loggers on the dashboard has been completed • The number of time zones has been fundamentally revised • The number of the max. available SMS alarms was stated per month, not per year. This error has been rectified • The status of the still active alarms is better presented on the dashboard • The error that in some cases the data was not fully shown in the table view, has been rectified • The error that in individual cases not all alarms were shown in the alarm list, has been rectified • The error that a WiFi data logger retained its alarm setting after being deregistered and reregistered, has been rectified • The error that a WiFi data logger sometimes still had alarm settings stored after a hardware reset, has been rectified • The error that the set user language was not taken into account in the setting of the communication rate, has been rectified • The error that the change of the user role was not always taken over, has been rectified • The error that during registration the previously selected country can no longer be changed after selecting the language, has been rectified • The error that the e-mail address for a deleted user can no longer be used, has been rectified • The error that licence information was sometimes displayed incorrectly in the Quick Start Guide, has been rectified • The error that for the dew point and absolute humidity channels the alarm did not function, has

Revision	Release date	Improvements
		<p>been rectified</p> <ul style="list-style-type: none"> • The error that when measuring in °F the e-mail and SMS alarms were always shown in °C, has been rectified • The error that the measurement locations could not be removed from existing alarm settings, has been rectified • The category "User groups" has been removed • The colour design on the web presentation is now uniform • With immediate effect, the dash board displays only active alarms • Browser compatibility problems in the presentation of the dashboard have been corrected • In a CSV report, tables and alarms cannot be integrated simultaneously, although this combination was selectable in the software interface. This error has been rectified • Decimal points and commas are supported for alarm limit value input • Limit values can be entered in °F or °C in alarm settings • A maintenance page is shown when maintenance work on the Cloud is being carried out • When changes to the selected analysis area were carried out, individual errors in the presentation occurred. This has been corrected • For months with fewer than 31 days, the full 31 days could still be selected in the time selection. This error has been rectified • Only a limited number of characters could be used for descriptions. The length of the fields has been adjusted accordingly • Suspended alarms are now identified as such • Alarm limit values outside the physical limits

Revision	Release date	Improvements
		of the testo Saveris 2 probes can no longer be entered (e.g. 105 %RH)
10955	2015-04-07	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="396 316 953 373">• The quick start guide is adapted to the new licence model<li data-bbox="396 389 897 446">• Some bugs in the graphic function are resolved<li data-bbox="396 462 897 520">• Measurement point names are shown instead of channel names above the graphic<li data-bbox="396 536 904 593">• The error that the alarm symbol shows “disabled” has been rectified

